



Saint-Gobain Life Sciences

お客様各位

アクロン工場製チューブの外箱変更について

拝啓 時下、ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。また、平素は格別のご高配を賜り誠にありがとうございます。サンゴバン アクロン工場では、一部製品の外箱を変更します。詳細は以下のとおりです。

通知内容の説明

サンゴバンでは箱に印刷されたブランド名と中の製品を一致させます。新しい箱は以前のものと同じサイズと強度です。またポリバッグを含むその他副資材に変更はありません（添付資料参照）。

適用範囲

対象は、添付資料2に記載のアクロン工場製チューブ製品になります。

変更理由

この変更により、箱に印刷されたのブランド名と中の製品が一致します。また、100%リサイクル可能な箱を使用することで、より環境に配慮し、我々のサステナビリティ目標の達成を目指します。

変更の影響/リスク評価

製品自体に変更はなく、影響は軽微なものと考えられます。

実施予定

2025年4月以降に実施予定となります。変更前の外箱の在庫が消費されるまでの間、変更前後の外箱が混在する場合があります。

お客様には大変ご迷惑をお掛け致しますが、ご理解とご協力をお願い申し上げます。ご不明な点は、営業担当もしくはカスタマーサービスまでお問い合わせ下さい。


敬具

2025年2月6日
サンゴバン株式会社 機能樹脂事業部 ライフサイエンス
〒391-0106 長野県諏訪郡原村 10801-5
TEL : 050-8882-6342 FAX : 0266-70-1002
Email : ls-japan@saint-gobain.com
【CO-04653-J】


添付資料



← 現行アクロン工場製
タイゴンブランド製品の外箱

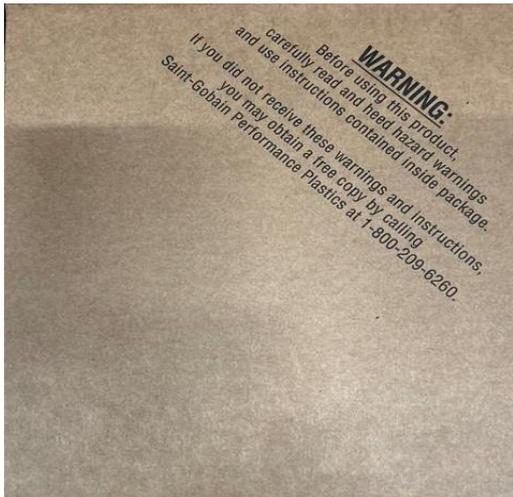

← 現行アクロン工場製
ファーマピュア、ファーマド、
サニピュア製品の外箱

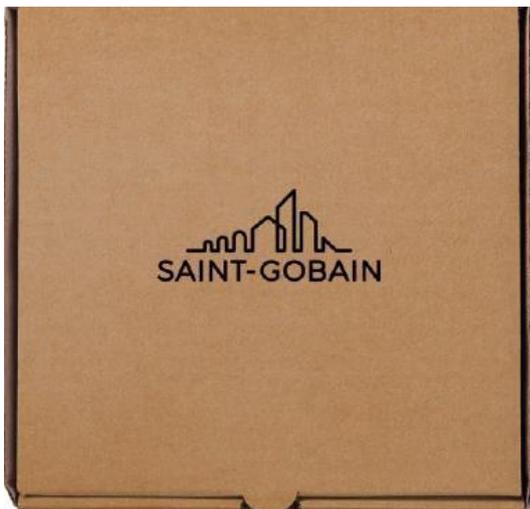

← 新しいアクロン工場製
チューブ製品の外箱



Saint-Gobain Life Sciences

添付資料 2 対象製品

Tygon® 2475
Tygon® 2475 IB
Tygon® MPF-100
Tygon® MPF-300
Tygon® ND 100-40
Tygon® ND 100-55
Tygon® ND 100-65
Tygon® ND 100-70
Tygon® ND 100-80
Tygon® S-22-238
Tygon® S-33-066
Tygon® S-33-080
Tygon® S-44-0
Tygon® S-74-HL
Tygon® S-97-E
C-Flex® Braided Tubing
PharmaPure®
PharMed® BPT
SaniPure™ BDF™