



Saint-Gobain Life Sciences

お客様各位

管理番号 : 2025-940-003

C-フレックスの品質証明書の添付方法の変更について

拝啓 時下、ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。また、平素は格別のご高配を賜り誠にありがとうございます。この度、サンゴバン 諏訪工場では C-フレックスの 15m 品の品質証明書（以下、CoC）の添付方法を変更いたします。詳細は以下のとおりです。

通知内容の説明

サンゴバン諏訪工場では、C-フレックスの 15m 品につきましては包装品 1巻ごとに CoC を 1枚添付しておりますが、今後は外箱への添付に変更いたします（添付資料 1 参照）。販売代理店様等におかれましては、必要に応じて CoC をコピーの上、適宜製品への添付いただきますようお願いいたします。

適用範囲

対象は以下のチューブになります。なお、スプール品（品番の末尾に S または M が付く品番）は従前から 1巻に 1枚の CoC を添付いたしておりますので、本変更の対象外となります。

製品	品番
C-フレックス	050 で始まる品番
	072 で始まる品番
	082 で始まる品番
	374 で始まる品番

変更理由

使用資材削減による環境負荷軽減を通じ、サステイナブル目標の達成を目指すことを目的としております。

変更の影響/リスク評価

製品自体に変更はなく、本変更による影響はありません。

実施予定

2026 年 1 月 1 日以降の出荷分より実施となります。

お客様には大変ご迷惑をお掛け致しますが、ご理解とご協力をお願い申し上げます。ご不明な点は、営業担当もしくはカスタマーサービスまでお問い合わせ下さい。

敬具

2025 年 12 月 1 日
サンゴバン株式会社 機能樹脂事業部 ライフサイエンス
〒391-0106 長野県諏訪郡原村 10801-5
TEL : 050-8882-6342 FAX : 0266-70-1002
Email : ls-japan@saint-gobain.com




Saint-Gobain Life Sciences

添付資料 1

【変更前】

1巻ごとに1枚のCoCを添付。

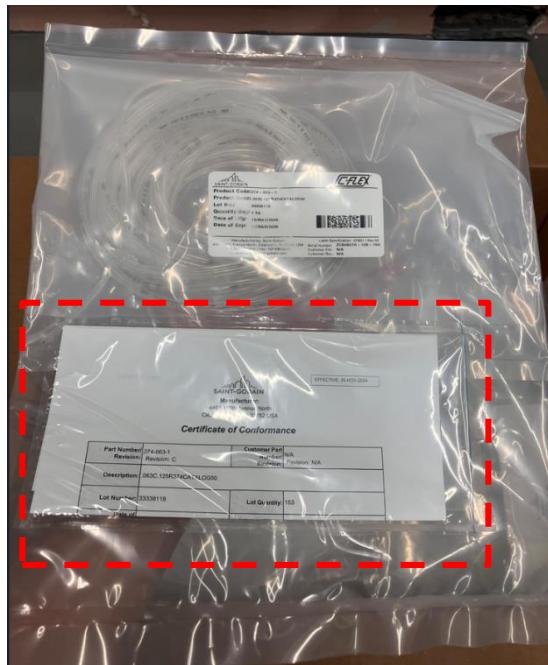

【変更後】


出荷梱包箱にロット毎に1枚を添付。

出荷案内書と同梱が基本となります。同一ロットが複数の箱に入る場合はCoCのみ各箱に添付されます。

同梱されるロットや品番が多い場合などは、状況に応じ出荷案内書とは別に添付させていただく場合もあります。



出荷案内書と同梱の場合

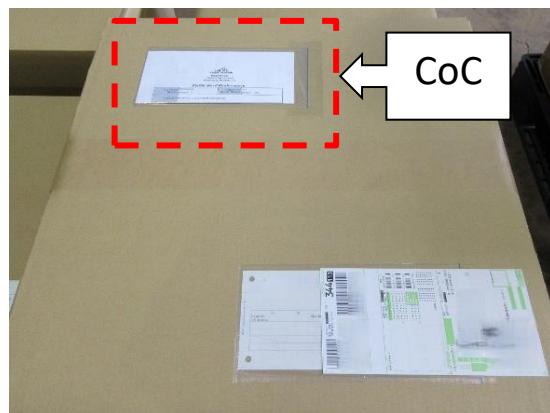

出荷案内書と別添の場合